MASS SPECTROMETRY REPORT

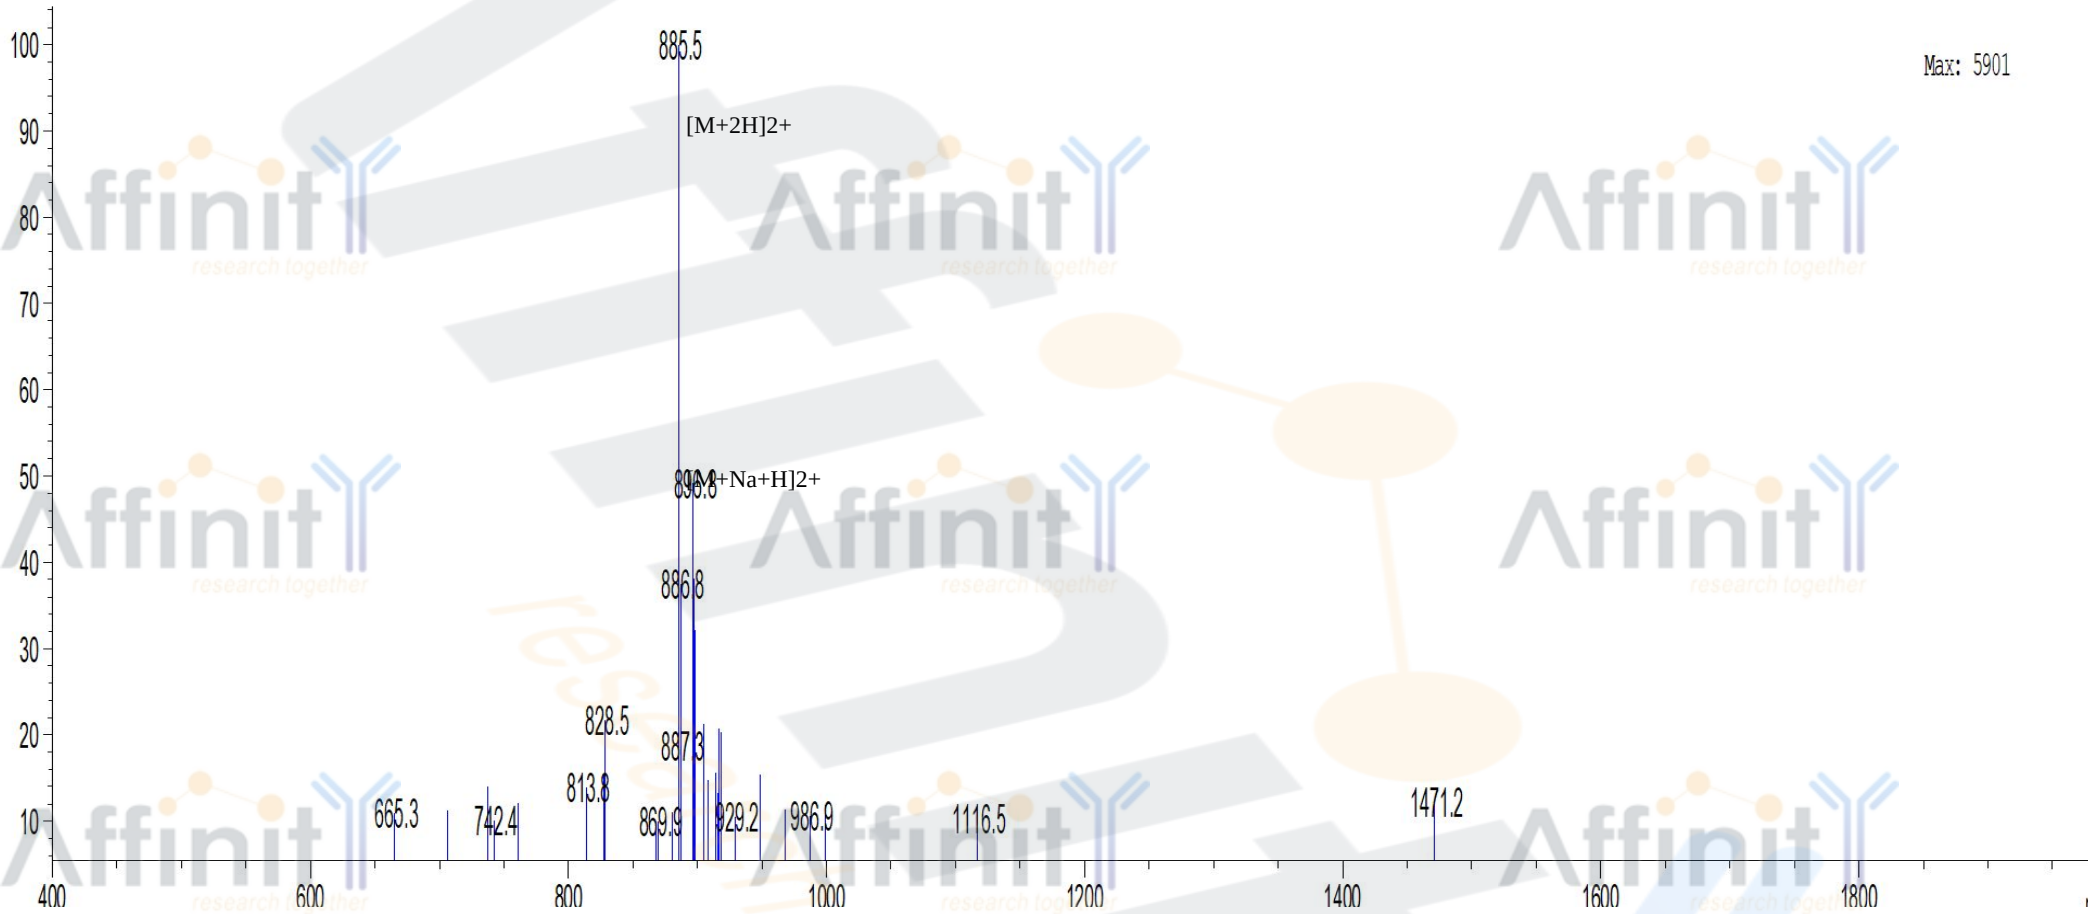

Sample Description		Instrument	Agilent-6125B		
Analyzed date:	2015-06-22	Probe:	ESI	Probe Bias:	＋4.5kv
Analyst:	YU	Nebulizer Gas Flow:	1.5L/min	Detector:	1.5kv
Sample:	S-16	CDL:	-20.0v	T. Flow:	0.2ml/min
M.W.:	1769.71	CDL Temp.:	250 ^{o}C	B. Conc.:	50%H2O/50%ACN
Lot. No.:	P150620-WD658876	Block Temp.:	200 ^{o}C		